



公司已通过 ISO9001:2008 认证

JW-450 标准钢砧

使用说明书

天津市津维电子仪表有限公司

1. 适用标准： JJG817-2011《回弹仪》检定规程 7.1.2

2. 钢砧芯硬度： 该钢砧各部件由优质钢及优质工具钢制成。砧芯与砧体的配合面经精细研磨而成，砧心面硬度为 HRC58-62。

3. 适用范围： 钢砧是对混凝土，砂浆，砖等回弹仪进行校验的检验工具。适用于 HT-450， HT-550 高强回弹仪。

4. 钢砧本体重量： 20kg

5. 钢砧本体尺寸： $\Phi 155 \times 138 \text{mm}$


6. 钢砧护套尺寸： 内径 $\Phi 55 \times 107 \text{mm}$

7. 使用方法及注意事项：

钢砧外形示意图见左侧，当回弹仪进行钢砧校验时应一般放置在水平面上校验回弹仪，回弹仪垂直向下作弹击实验，校准回弹仪的率定值。混凝土回弹仪在本刚砧上作弹击实验的平均率定回弹值根据相应国家级行业标准而定。

回弹仪校验钢砧作为检验工具，被弹击试验 5000 次-8000 次后，可将砧芯连同砧体在平面磨平整再用，但砧芯硬度仍需保持 HRC58-62, 否则不得再用。

回弹仪校验钢砧平时保存在干燥防尘处，以防锈蚀，弹击试验面不得随意磕碰, 以保证检验工具的标准状态。

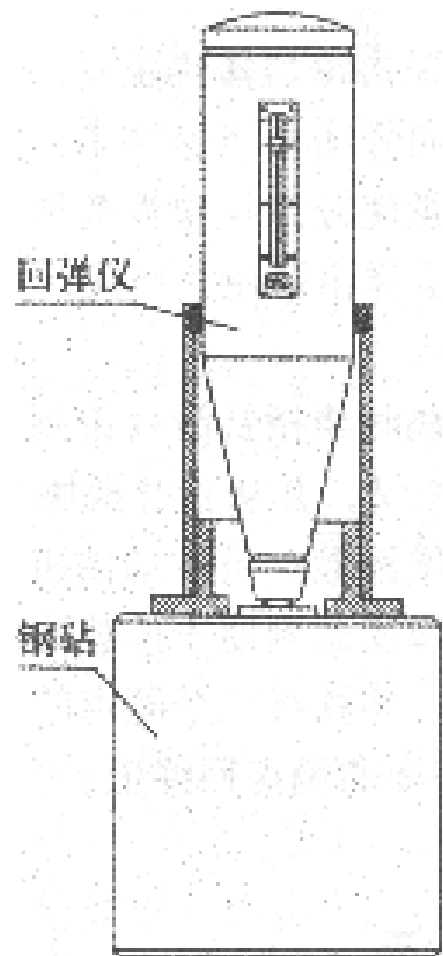



天津市津维电子仪表有限公司

厂址：天津市南开区咸阳路罗平道 6 号 4 门 101

电话：022-27638649 022-27652788

传真：022-27366750

官网：<http://www.tj-jwdz.com>

E-mail：sjjw@vip.163.com